しゃもG

しゃもじ ＋ Gravity

特許出願中

カタログ番号	全長	シャフト幅	ヘッド部幅	穴径	JANコード
SYAMO-60050	600mm	50mm	100mm	直径60mm	4545428040116

【安全にご使用いただくために】

■本製品をご使用の際、患者様の体形を考慮の上ご使用下さい
■本製品をご使用前に製品表面に傷、変形などがないことをご確認の上ご使用下さい
■本製品は表面を上にしてご使用下さい。（表面は内側に湾曲しています）
■本製品シャフト部分を背中もしくは腹部の中心に合わせてご使用ください
■本製品の穴の中心に頭部が収まっているか確認してご使用下さい
■本製品を抜去する際は水平にゆっくり引き抜いてください
■本製品の洗浄は清拭で実施して下さい。薬品等を使用すると変色する可能性があります
■本製品は陽極酸化をしております
■この製品が補助具であることを理解し作業を行う際には適切な注意を払って使用してください

詳しくはこちら

仕様・外観につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください

【製造販売元】 **株式会社パイオラックスメディカルデバイス**
〒245-0053 横浜市戸塚区上矢部町2265-3
【製品に関するお問い合わせ先】
TEL：045-517-9740 FAX：045-811-8560

PIOLAX

C-SYAMO-22508V1PMD

しゃもG使用方法

手術台にしゃもGを設置

背中の中心にシャフト部を合わせる

表側が上になるように手術ベッドにしゃもGを敷きます。
ちょうどしゃもGの径が細くなる部分が手術ベッドの
頭と体の境界線に来るように敷きます。

※赤線＝しゃもG

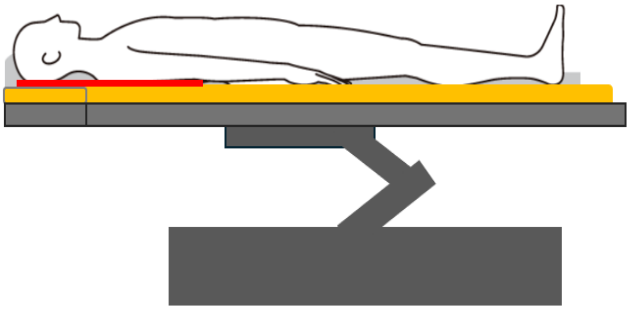

① 頭部中心がしゃもG穴に合うよう頭部を合わせる

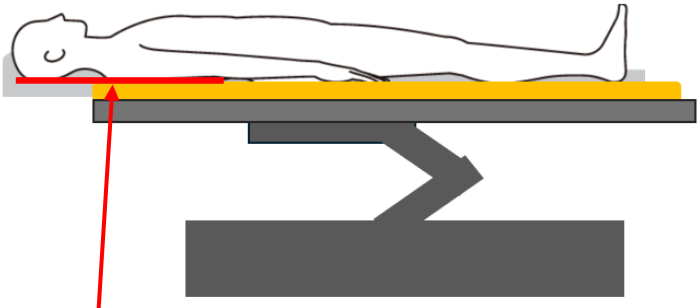

② 頭部手術台を外す
頭部が安定していることを確認する

敷いているマットが沈み込むことが想定される場合、
適宜ベッドの傾きを調整しご使用ください。

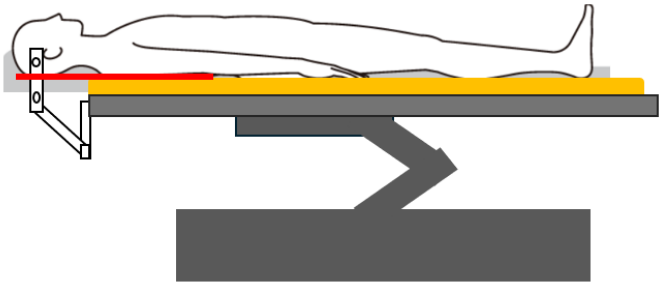

③ ピン固定を行う

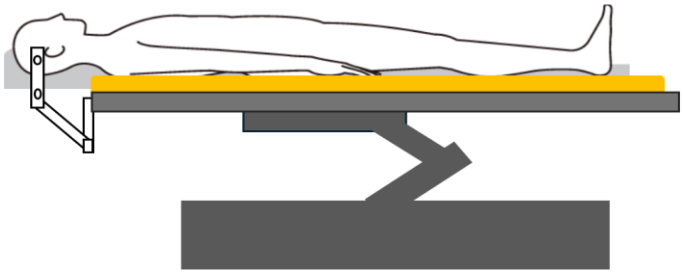

④ しゃもGを水平に抜く

PIOLAX